


Prosenttiarvojen vertailu

25-75% 0-90%

Keskiarvo A



HH-suhde (g/U) * (A)	21,0	10,0	11,0	11,0	13,0	17,0	18,0
(B)	21,0	9,0	10,0	10,0	12,0	17,0	18,0

Hypoglykemia vaihtelut (4)**


Jaksojen lkm. (vrk): 1,6

Hyperglykemia vaihtelut (12)**

Jaksojen lkm. (vrk): 2,8

1 04:00 - 04:59
(3 tapahtuma[a])2 13:00 - 13:59
(2 tapahtuma[a])3 14:00 - 14:59
(2 tapahtuma[a])4 10:00 - 10:59
(5 tapahtuma[a])5 00:00 - 00:59
(3 tapahtuma[a])6 07:00 - 07:59
(3 tapahtuma[a])

Aika tavoitealueella



SmartGuard-lopetukset

Ei kalibrointia	A 0	B 2
SmartGuard-maksimiannostelu	A 0	B 0
SmartGuard-minimiannostelu	A 0	B 0
VS pakollinen SmartGuard-toiminnolle	A 0	B 0
Sens. algoritmin todellista pienempi arvo	A 0	B 0
Sensoria päivitetään	A 0	B 0
Ei SG-arvoja	A 1	B 1
Sens. käyttöaika ylittynyt	A 0	B 0
Käyttäjä poisti SmartGuard-toiminnon käytöstä	A 7	B 6
Pitkäkestoinen pysäytys	A 0	B 0
SmartGuard-alustus	A 0	B 0
Määrittämätön	A 0	B 0


Tilastotiedot

SmartGuard (viikossa)	A 99% (6vrk 22h)	B 98% (6vrk 21h)
Manuaalinen tila (viikossa)	A 1% (02h)	B 2% (03h)
Sensorin käyttö (viikossa)	A 89% (6vrk 06h)	B 94% (6vrk 15h)
SG-keskiarvo ± keskihajonta	A 8,9 ± 4,2 mmol/l	B 8,9 ± 4,5 mmol/l
GMI***	A 7,1% (54,4 mmol/mol)	B 7,2% (54,8 mmol/mol)
Variaatiokerroin (CV, %)	A 47,4%	B 50,6%
Matala/korkea SG -varoit. (vrk)	A 8,6 / 8,6	B 7,5 / 7,6
VS-keskiarvo	A 11,8 ± 7 mmol/l	B 11,4 ± 6 mmol/l
VS/kalibrointi (vuorokaudessa)	A 3,3 / 2,7	B 3,2 / 2,7
Vrk-annostelu yhteensä (vuorokaudessa)	A 38,0 yksikköä	B 46,5 yksikköä
Bolusmäärä (vuorokaudessa)	A 22,2U (58%)	B 28,9U (62%)
Autom. korjausmäärä (vuorokaudessa)	A 10,8U (49%)	B 14,1U (49%)
Autom. basal-/basalmäärä (vuorokaudessa)	A 15,8U (42%)	B 17,6U (38%)
Setin vaihto	A 4,5 vrk	B 2,0 vrk
Säiliön vaihto	A 3,0 vrk	B 5,0 vrk
Ateria (vuorokaudessa)	A 4,1	B 4,9
Syötetyt HH:t (vuorokaudessa)	A 111 ± 50 g	B 174 ± 93 g
Akt. insuliinin aika	A 2:30 h	B 2:30 h

* Näkyvissä pumpun viimeisimmät asetukset.

** Näkyvissä vain tärkeysjärjestyksessä ylin.

*** Laskennallinen glukoositasapaino.

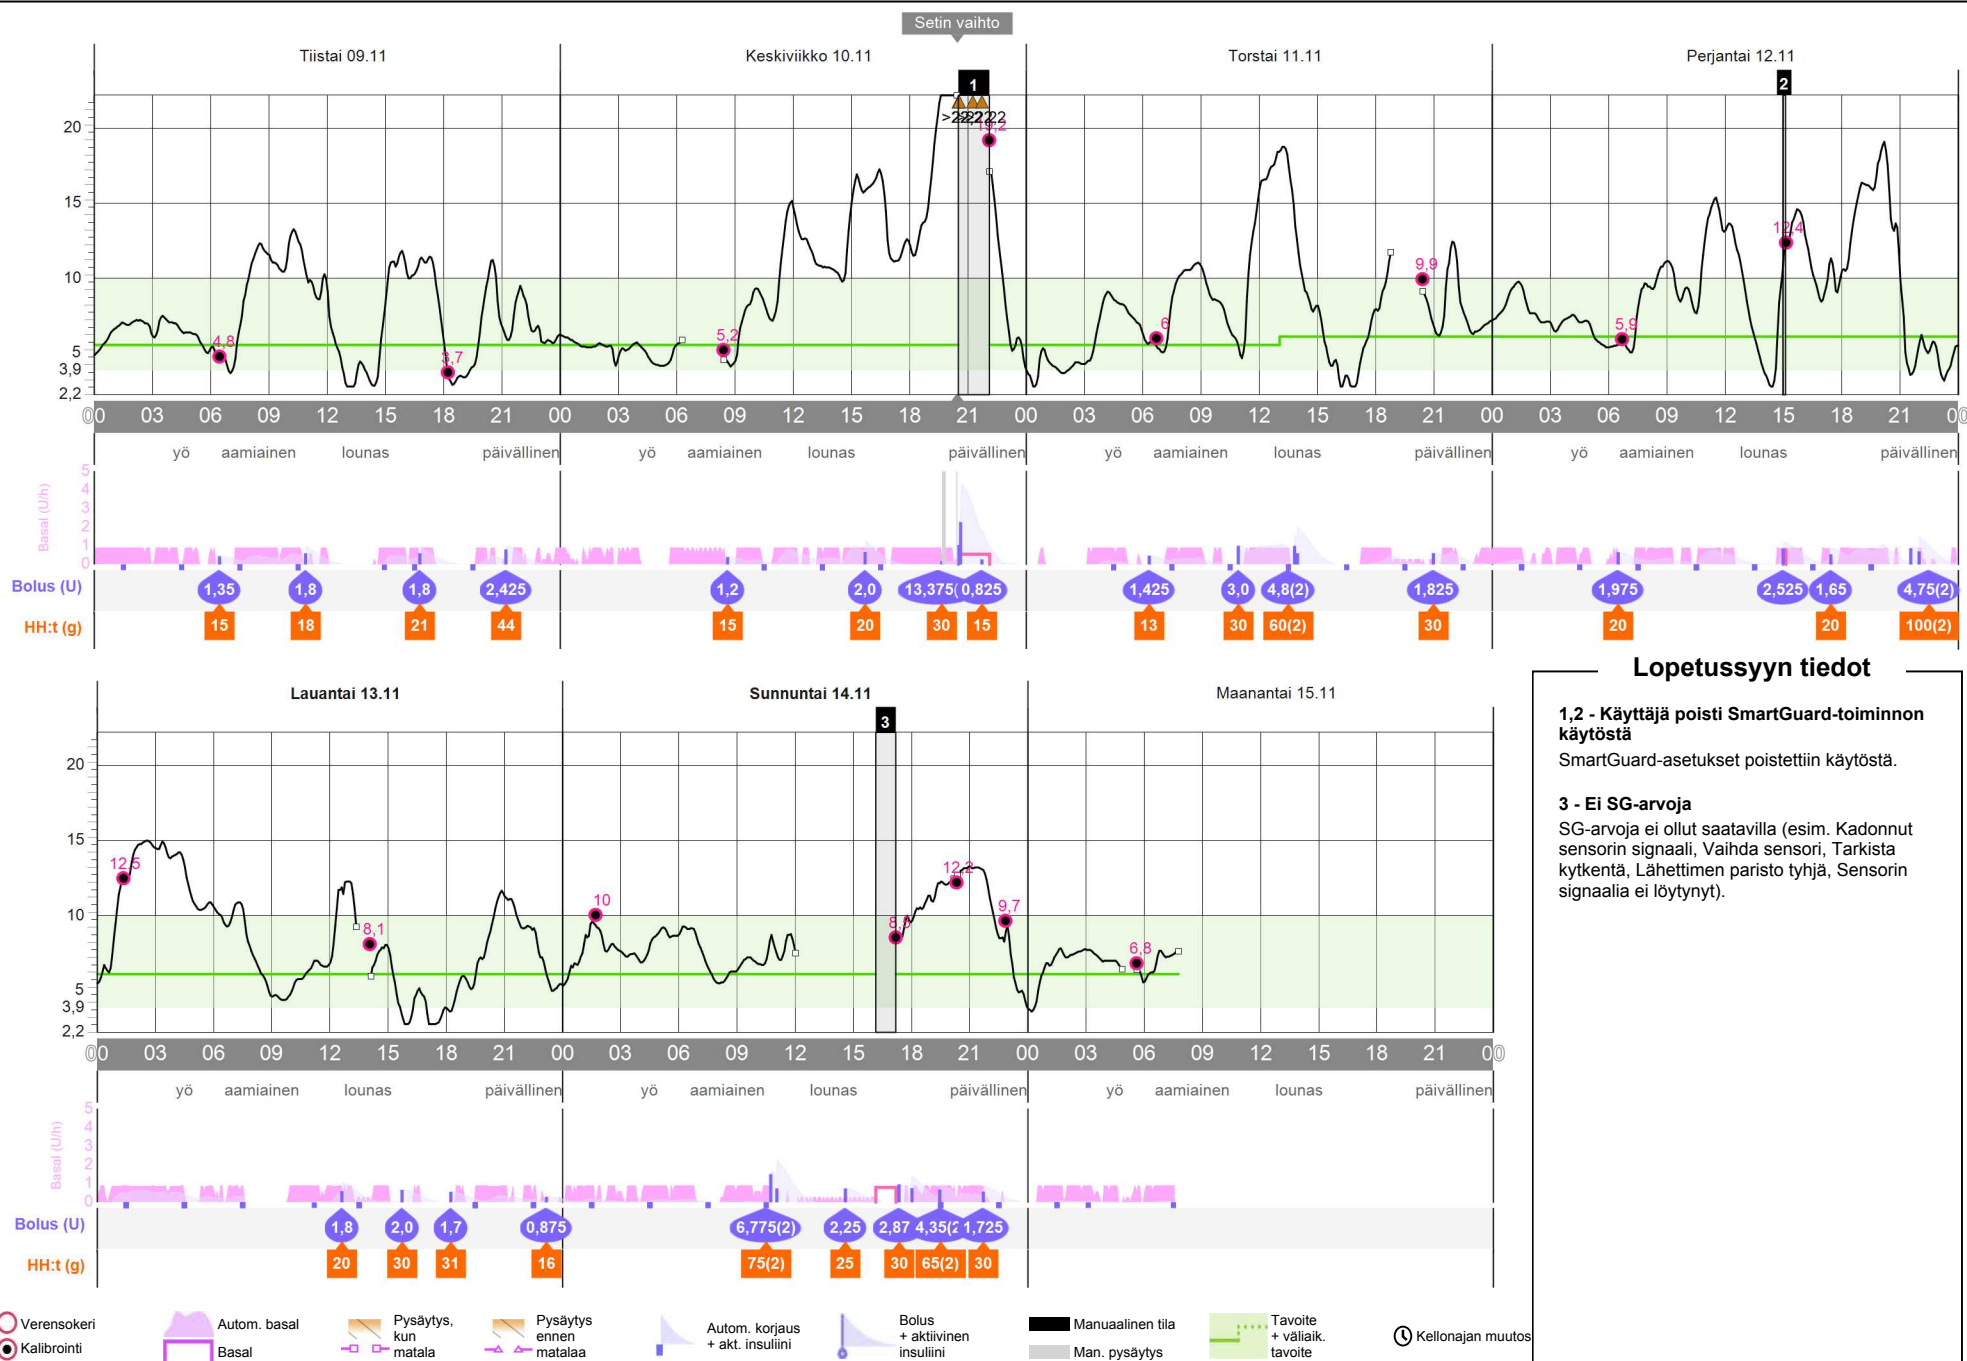

Lopetussyyntiedot

1,2 - Käyttäjä poisti SmartGuard-toiminnon käytöstä

SmartGuard-asetukset poistettiin käytöstä.

3 - Ei SG-arvoja

SG-arvoja ei ollut saatavilla (esim. Kadonnut sensorin signaali, Vaihda sensori, Tarkista kytkentä, Lähettimen paristo tyhjä, Sensorin signaalia ei löytynyt).